

Alarma de Zona Digital Medical Gas Alarm Zone



Alarma de Zona digital para Monitoreo de presión de gases medicinales, desde 1 hasta 6 tipos de gas o más en un solo panel de control.

Sistema primario controlado por un microprocesador diseñado para exceder los requerimientos de las normas NFPA99-2002.

El sistema de panel es 100% digital y no requiere calibración; el sistema es compatible para realizar interface con el equipo de alarma maestra de monitoreo Arigmed que puede usarse como elemento de sistema de red.

La estructura de la caja de la alarma está fabricada en aluminio con acabado en pintura electrostática y los rangos de permisibilidad eléctrica son de 90 a 127 v, 60 hzt. La fuente de poder está particularmente incluida por cada módulo de gas, en forma aislada en un compartimiento designado para su funcionamiento. El panel de control contiene señales audibles y luminosas, además de un botón silenciador.

Esta alarma permite monitorear desde 1 hasta varios gases (previa especificación del cliente), y cada módulo de monitoreo señala con exactitud la presión de cada uno de los gases conectados.

La alarma es programable con el botón de EDITAR para los límites de alta/baja. La función de "recordatorio" suena en cualquier condición de la alarma, no importa que se utilice el modo de "silencio" la luz de advertencia continua intermitentemente destellante en condición de alarma, hasta el restablecimiento de la presión a condición normal.

La alarma viene calibrada de fábrica en unidad de medida PSIG y en rangos de baja en límites de - 4 Kg./cm² y alta de + 7 kg/cm².



ESPECIFICACIONES

- ▶ 100% Digital.
 - ▶ En cumplimiento con NFPA 99C 2005.
 - ▶ Unidad autocontenida de uno a varios gases (sobreponer o montaje a muro).
 - ▶ Controlada por microprocesador.
 - ▶ Indicadores audiovisuales (alto/bajo/normal).
L.E.D brillantes y claramente visibles para situaciones de día /noche.
 - ▶ Monitoreo de presión para cada gas.
 - ▶ Programa de usuario para límites de presión (histéresis).
 - ▶ Carátula electrolumínica en condición de alarma
1 año de garantía.
 - ▶ Diseñado para fácil instalación y servicio.
 - ▶ Con escala de presión (BAR, PSIG).
- ▶ Cada Módulo de gases contiene:
 - ▶ Una luz verde para indicar presión normal.
 - ▶ Una luz roja para indicar condición de presión alta/baja bajo los requerimientos dispuestos en la histéresis.
 - ▶ Unidades de medida señaladas en el display de lectura.
 - ▶ Color del módulo del gas según código de color NFPA.
 - ▶ Display en color verde brillante para situación "NORMAL".
 - ▶ Carátula con luz electrolumínica en situación de alarma por cada módulo de gas (luz color azul).
 - ▶ Escala de barra en referencia a condiciones: verde=normal, rojo=anormal.

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone


VISTAS



Vista isométrica

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

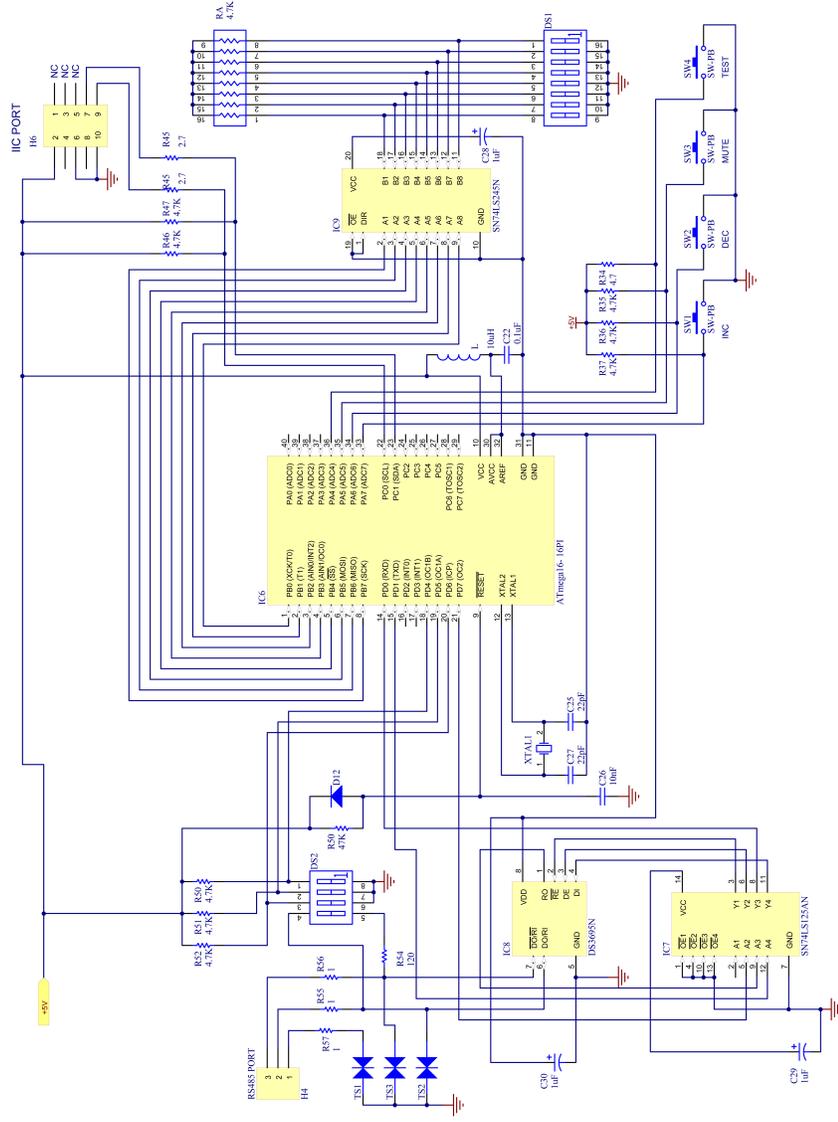

Alarma de Zona Digital (Maestra)
DES - EYC - 002
UCP_ZALARM_M (Tarjeta Maestra)



arigmed

GRUPO ARIGMED S. de R.L. de C.V

Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huitzila, Tizayuca, Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008


www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

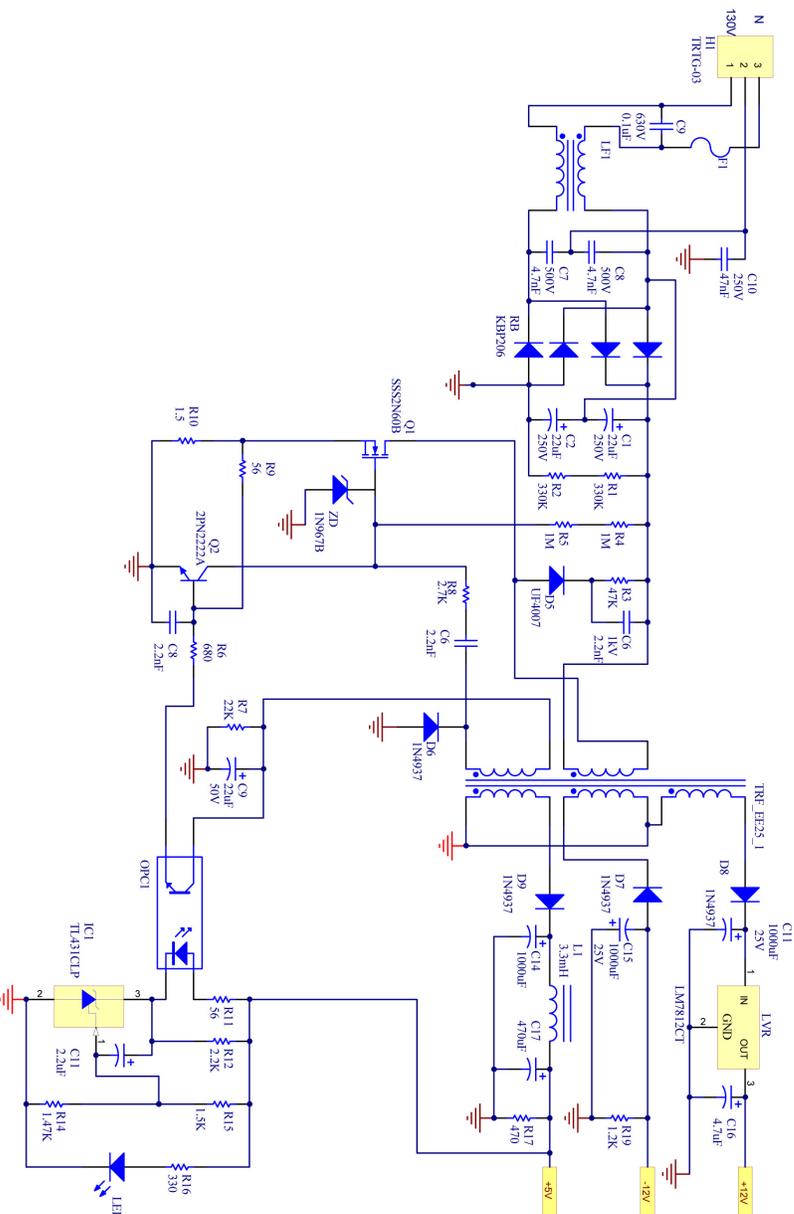

Alarma digital de zona
PLA - ELC - 002
UCP_ZALARM_M (Tarjeta Maestra)



arigmed
MIR


GRUPO ARIGMED S. de R.L. de C.V
 Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huixtla, Tzayuca Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008
www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

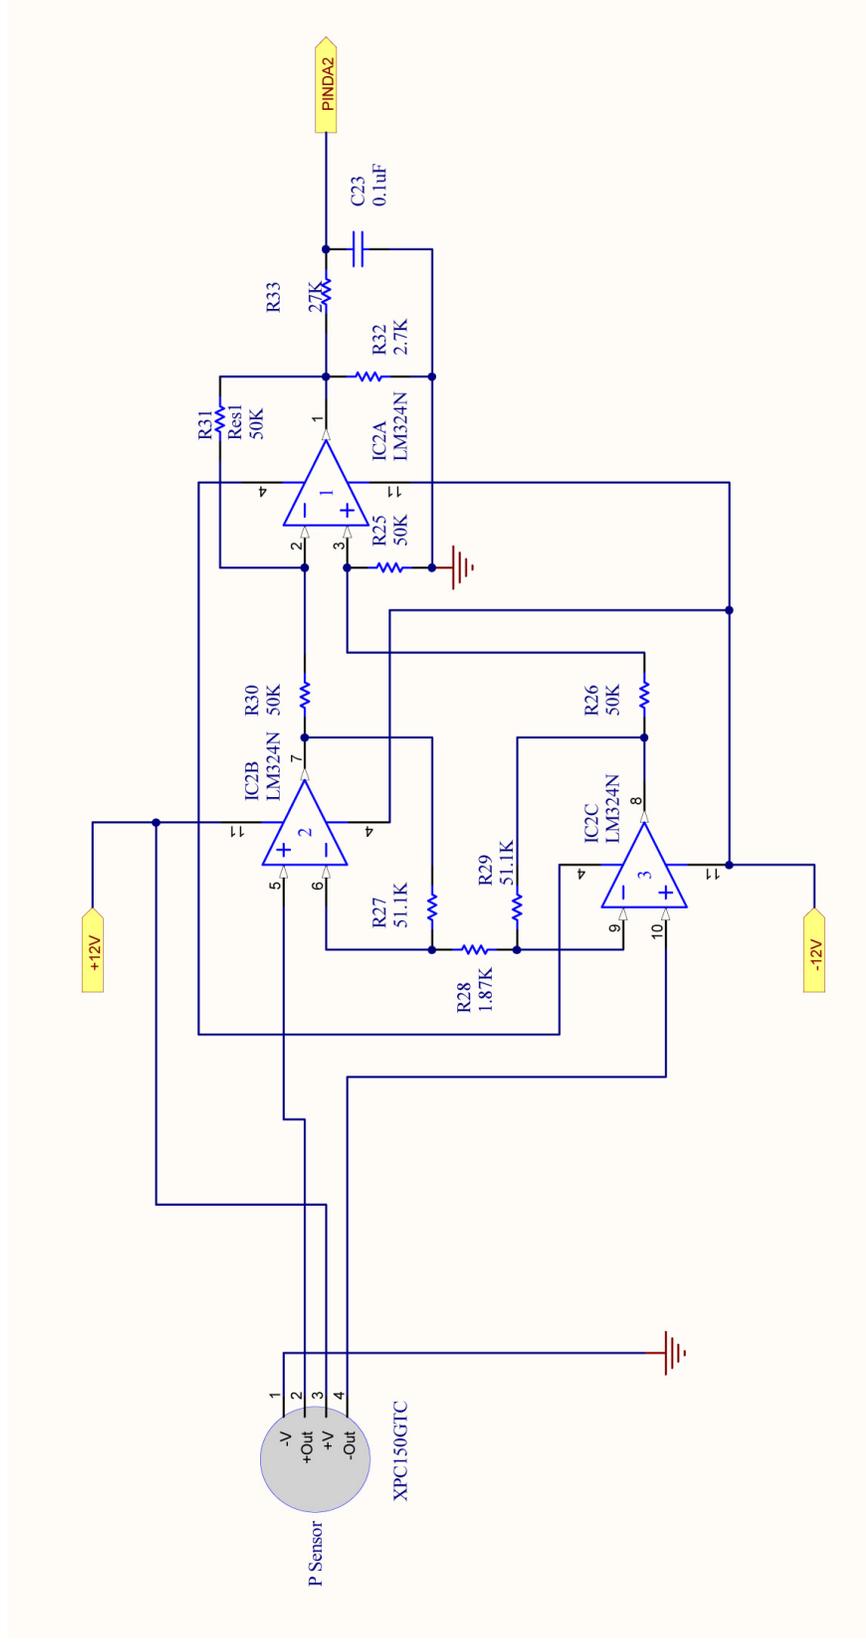

Alarma digital de zona
PLA - ELC - 002
UCP_ZALARM_M (Tarjeta Maestra)



GRUPO ARIGMED S. de R.L. de C.V


Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huiztla, Tizayuca, Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008
www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUIAS MECÁNICAS

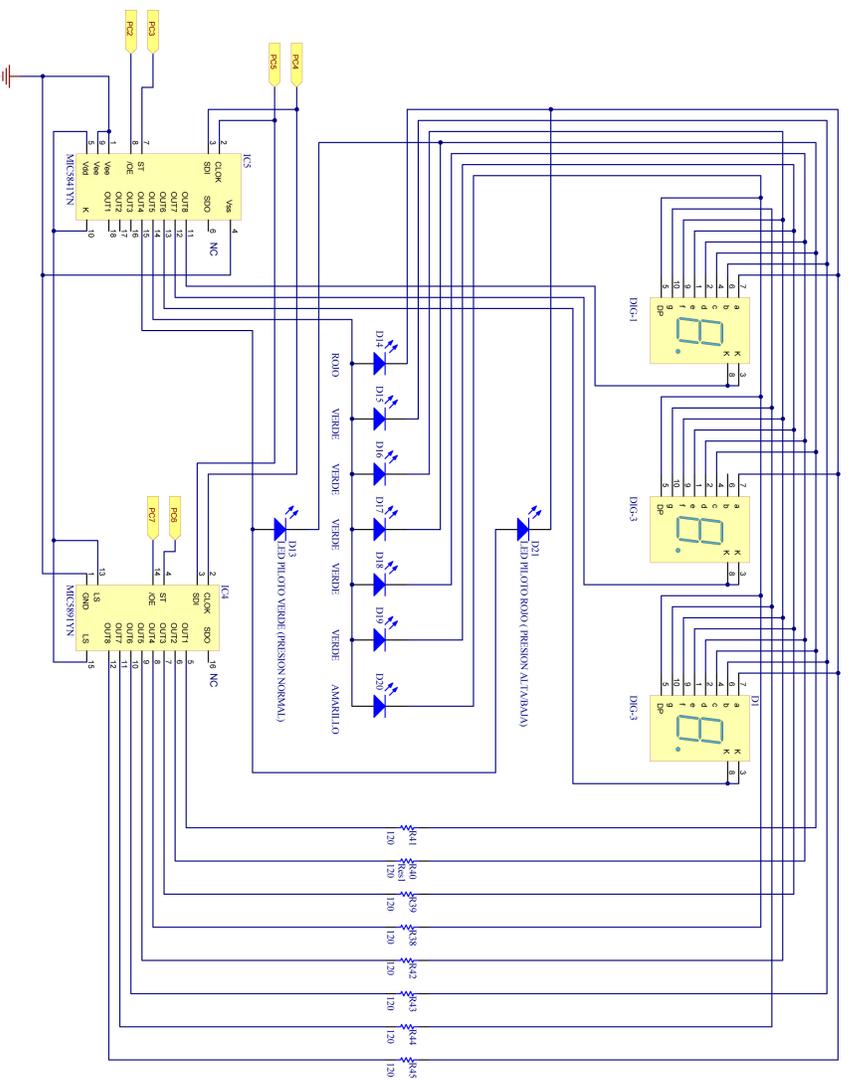

Alarma digital de zona

PLA - ELC - 002

UCP_ZALARM_M (Tarjeta Maestra)



arigmed

MFR

GRUPO ARIGMED S. de RL de C. V

Calle 16 de Enero de 1989 No.6 Huiztla, Tzayuca, Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008

www.arigmed.com ventas@arigmed.com


(779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

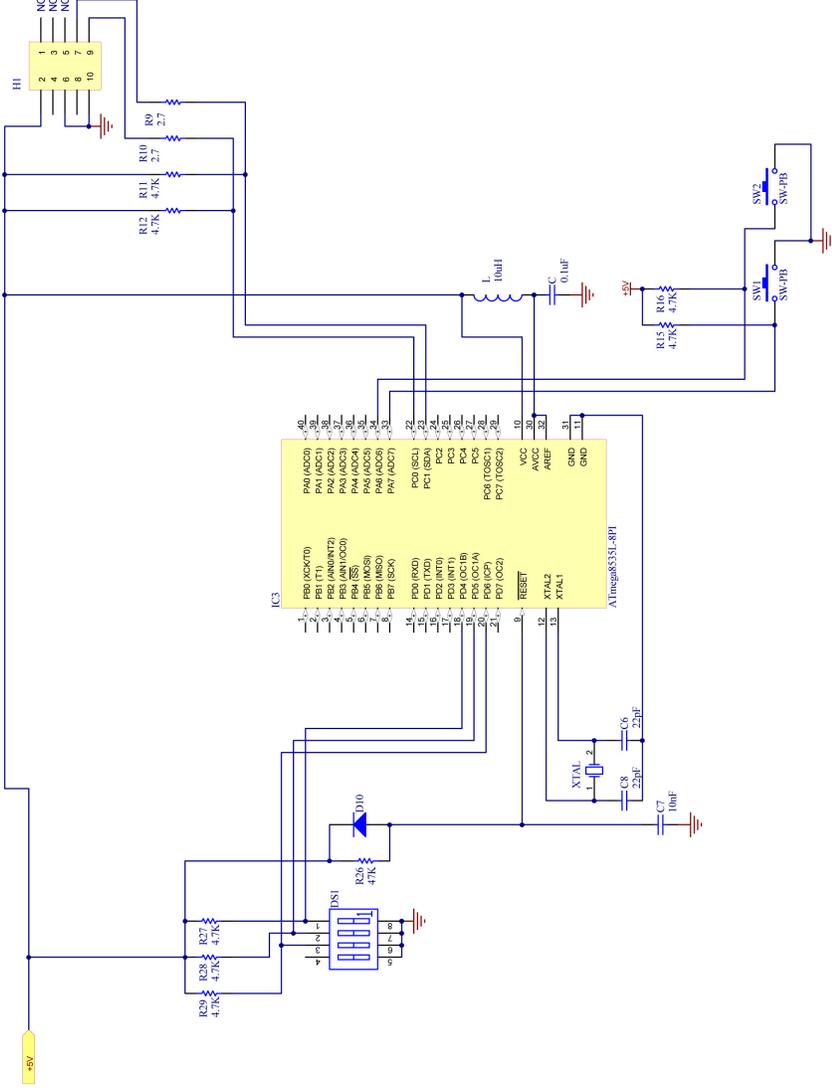

Alarma digital de zona (Esclava)
 PLA - ELC - 002
 UCP_ZALARM_S (Tarjeta Esclava)



arigmed

GRUPO ARIGMED S. de R.L. de C.V

Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huitzila, Tizayuca, Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008


www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

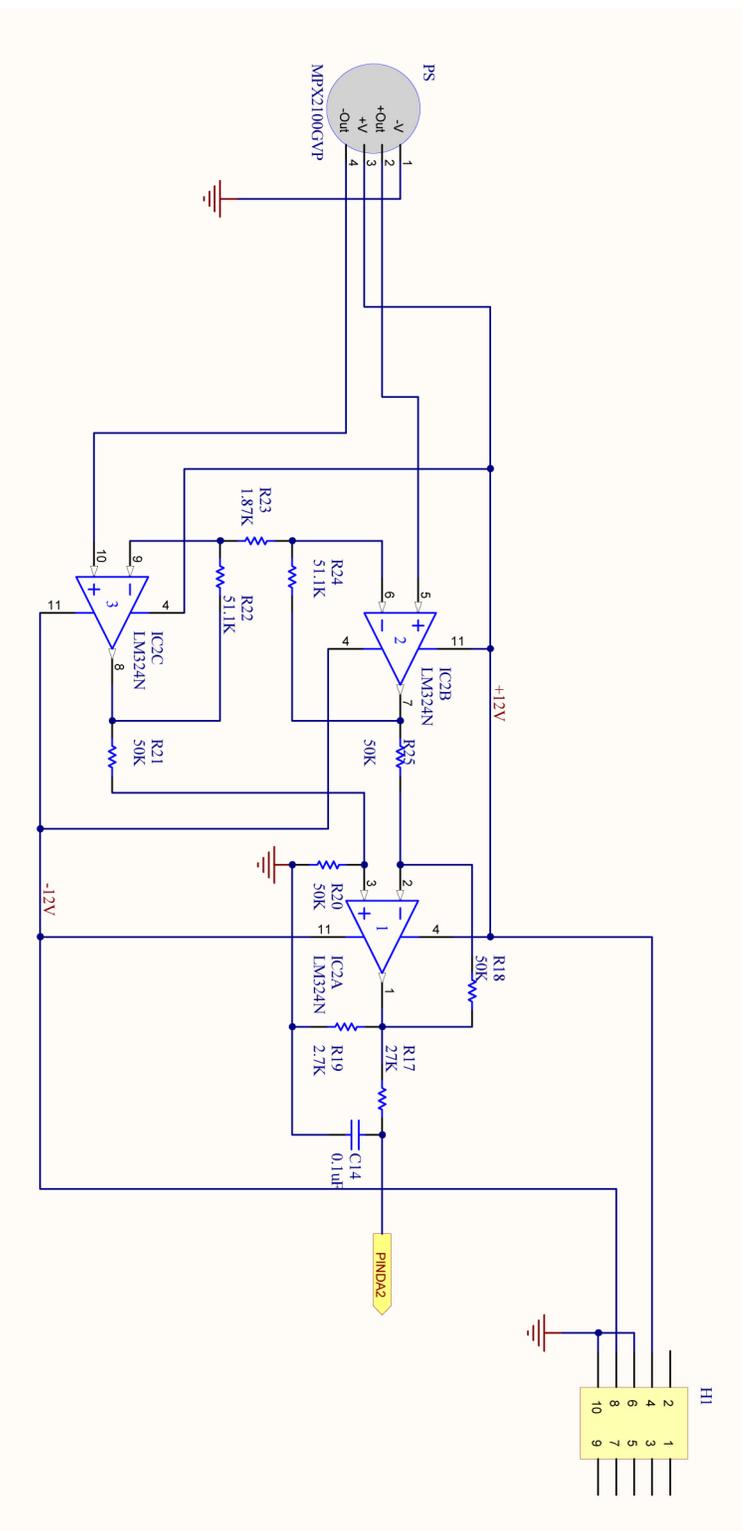

Alarma digital de zona

PLA - ELC - 002

UCP_ZALARM_S (Tarjeta Esclava)



arigmed


GRUPO ARIGMED S. de R.L de C.V
Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huiztla, Tizayuca, Estado de Hidalgo, Mexico Certificado ISO 9001:2008
www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008

Alarma de zona digital / Medical Gas Alarm Zone

GUÍAS MECÁNICAS

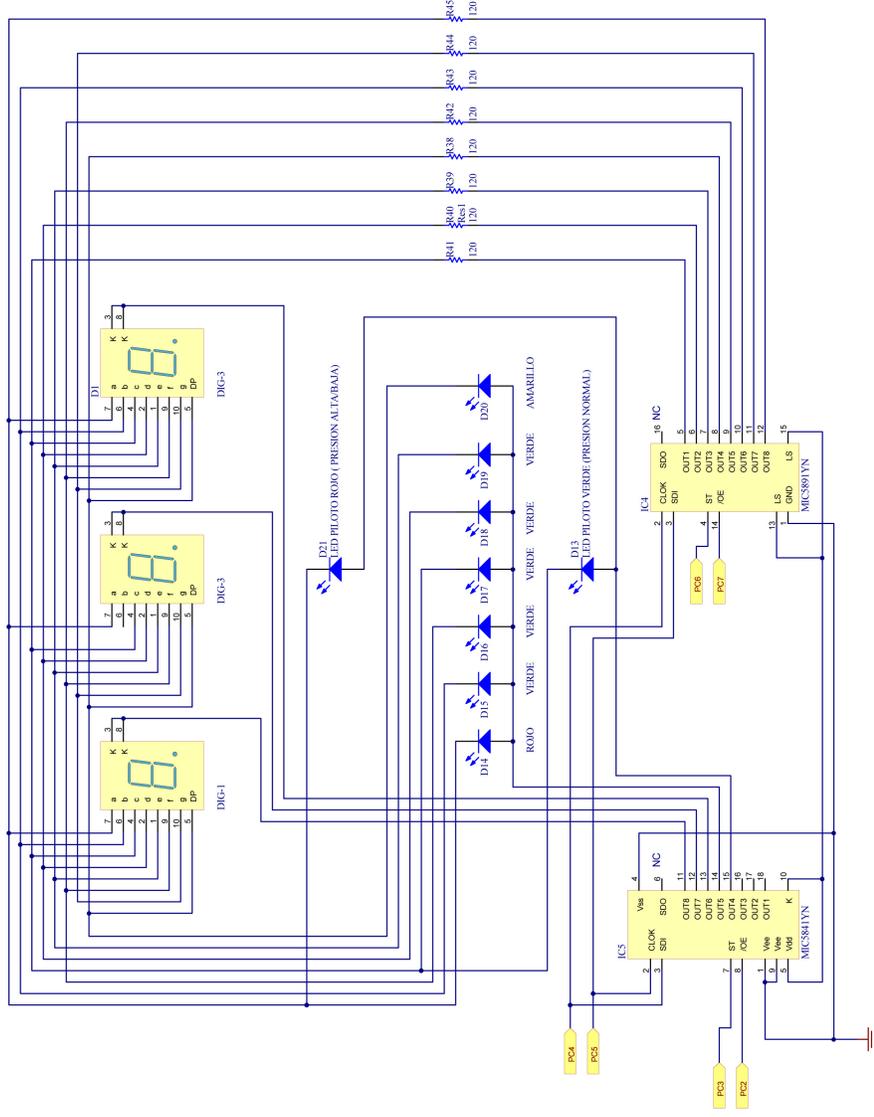

Alarma digital de zona
PLA - ELC - 002
UCP_ZALARM_M(Tarjeta Maestra)



GRUPO ARIGMED S. de R.L. de C.V

Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huiztla, Tizayuca, Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008
www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ISO 9001:2008